

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА Е 857ЭС-Ц**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

УИМЯ.411600.048 МП

Настоящая методика распространяется на преобразователи измерительные цифровые напряжения постоянного тока Е 857ЭС-Ц (в дальнейшем ИП) и устанавливает методику их поверки.

Методика поверки разработана в соответствии с требованиями РД РБ 50.8103-93, СТБ 8003-93.

1 Операции и средства поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Средства поверки. Тип и основные технические характеристики	Обязательность проведения операции при	
			первичной поверке	эксплуатации и хранения
Внешний осмотр	3.1		Да	Да
Определение электрического сопротивления изоляции	3.2	Мегаомметр Е6-16, номинальное напряжение 500 В, класс точности 1,5	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	3.3	Универсальная пробойная установка УПУ-1М, испытательное напряжение от 0 до 10 кВ, класс точности 4,0	Да	Нет
Определение допускаемой основной приведенной погрешности	3.4	1 Калибратор программируемый П320. Диапазон напряжений от 10^{-3} до 10^5 В. Класс точности 0,005 2 Преобразователь уровней RS-232/RS-485 3 ПЭВМ, Р-266, 32 Мб, Windows-98, Windows-XP 4 Вольтметр В7-65, диапазон напряжений от 0 до 300 В, класс точности 0,03 5 Катушка электрического сопротивления измерительная Р331, $R_{ном}=100$ Ом, класс точности 0,01. 6 Магазин сопротивления измерительный Р33, сопротивление от 0 до 99999,9 Ом, класс точности 0,2	Да	Да

1.2 Допускается использовать другие средства поверки, прошедшие поверку или метрологическую аттестацию и имеющие нормируемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в таблице.

Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттестации.

					УИМЯ.411600.048 МП			
Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата				
Разраб.	Семенас				Преобразователи измерительные цифровые напряжения постоянного тока Е 857ЭС-Ц Методика поверки	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Бабора					0	2	17
Гл. констр	Валентин							
Н.контр.	Семенас							
Утв.								
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата

2 Условия поверки и подготовка к ней

2.1 Поверка должна проводиться при следующих нормальных условиях:

- температура окружающей среды, °С	20±5;
- относительная влажность, %	30-80;
- атмосферное давление, кПа	86-106,7;
- напряжение питающей сети	Упит.ном.±2 %;
- частота питающей сети, Гц	50±0,5;
- внешнее магнитное поле	- магнитное поле Земли
- форма кривой напряжения питания	- синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности кривой напряжения не более 5 %
- сопротивление нагрузки на аналоговом выходе, кОм	2,5±0,5 на выходе 0-5; ±5 мА; 0,4±0,1 на выходе 4-20; 4-12-20 мА 10±1 на выходе по напряжению

2.2 До проведения поверки ИП должен быть выдержан во включенном состоянии без входных сигналов при температуре от 15 до 25 °С не менее 30 мин.

3 Проведение поверки

3.1 Внешний осмотр

3.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено отсутствие механических повреждений наружных частей, наличие клейма и четкость маркировки.

3.2 Электрическое сопротивление изоляции измерять мегаомметром с номинальным напряжением 500 В в нормальных условиях применения.

Показания, определяющие электрическое сопротивление изоляции, следует отсчитывать по истечении 1 мин после приложения напряжения.

ИП считают выдержавшим испытание, если измеренные значения электрического сопротивления цепей, указанных в таблице 2, не менее 20 МОм.

Таблица 2

Проверяемые цепи	Испытательное напряжение, кВ, для Un				
	1, 5, 10 В	60, 100 В	150 В	250 В	400, 500 В
Корпус – питание	2,3				
Корпус – вход	0,51	0,74	1,4	2,3	3,7
Корпус – все выходы	0,51				
Питание – вход	2,3				3,7
Сеть – все выходы	2,3				
Вход – все выходы	2,3				3,7
Выход 1 – выходы 2, 3	0,51				
Выход 2 – выход 3					
Примечание - Наличие цепей – в соответствии с модификацией ИП, указанной в таблице 1					

3.3 Электрическую прочность изоляции проверять в нормальных условиях по методике ГОСТ 12.2.091-2002.

Испытательное напряжение должно прикладываться между цепями, указанными в таблице 2.

ИП считают выдержавшим испытание, если не возникают разряды или повторяющиеся поверхностные пробои, сопровождающиеся резким возрастанием тока в испытываемой цепи.

					УИМЯ.411600.048 МП			Лист
								3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата

3.4 Определение основной погрешности проводить в соответствии со схемой приложения Б при значениях входного сигнала, равных 0, 20, 40, 60, 80, 100 % от верхнего значения (верхнего и нижнего значений для двуполярного входного сигнала) диапазона преобразуемого входного сигнала.

Для поверки ИП с выходом 1 (порт RS-485) необходимо установить на применяемой ПЭВМ программу УИМЯ.00001-01 для Windows-98 или УИМЯ.00001-02 для Windows-XP. Программы и руководство по их обслуживанию приведены в приложении Д.

Основную погрешность γ , выраженную в процентах, рассчитывают по формуле

$$\gamma = \frac{\text{Аизм} - \text{Арасч}}{\text{Анорм} \cdot R1} \cdot 100 \quad (1)$$

где Аизм – значение сигнала, отображаемое на мониторе ПЭВМ при определении погрешности для выхода 1 (порт RS - 485), в единицах;
 – значение сигнала, отображаемое на внешнем показывающем устройстве при определении погрешности для выхода 2, (порт показывающего устройства), В;
 – значение сигнала, измеренное вольтметром V2, В, при определении погрешности для выхода 3 (аналоговый выход).

Арасч – расчетное значение для данного значения входного сигнала.

R1 – величина сопротивления катушки P331, равная 100 Ом (учитывается только при определении погрешности по выходу 3).

При определении погрешности для выхода 1 Арасч указано в таблице 3.

При определении погрешности для выхода 2 Арасч указано в таблице 4.

При определении погрешности для выхода 3 Арасч указано в таблице 5.

Анорм – нормирующее значение.

По выходу 1 Анорм=5000 единиц.

По выходу 2 Анорм равно номинальному значению преобразуемого входного сигнала, указанному в таблице 4.

По выходу 3 Анорм равно верхнему значению диапазона изменения выходного сигнала.

Таблица 3 Расчетное значение при определении погрешности для выхода 1

Входной сигнал, % от верхнего (нижнего) значения диапазона преобразуемого входного сигнала	Сигнал отрицательной полярности					Сигнал положительной полярности					
	100	80	60	40	20	0	20	40	60	80	100
Арасч., единиц	-5000	-4000	-3000	-2000	-1000	0	1000	2000	3000	4000	5000

					УИМЯ.411600.048 МП						Лист
											4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата			

Таблица 4 Расчетное значение при определении погрешности для выхода 2

Диапазон преобразуемого входного сигнала, В	Номинальное значение преобразуемого входного сигнала (Ан), В	Арасч, В										
		Сигнал отрицательной полярности, % от нижнего значения диапазона входного сигнала					Сигнал положительной полярности, % от верхнего значения диапазона входного сигнала					
		100	80	60	40	20	0	20	40	60	80	100
0 – 1	1						0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
0 – 5	5						0	1	2	3	4	5
0 – 10	10						0	2	4	6	8	10
0 – 60	60						0	12	24	36	48	60
0 – 100	100	-					0	20	40	60	80	100
0 – 150	150						0	30	60	90	120	150
0 – 250	250						0	50	100	150	200	250
0 – 400	400						0	80	160	240	320	400
0 – 500	500						0	100	200	300	400	500
±1	1	-1,0	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
±5	5	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
±10	10	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
±60	60	-60	-48	-36	24	-12	0	12	24	36	48	60
±100	100	-100	-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80	100
±150	150	-150	-120	-90	-60	-30	0	30	60	90	120	150
±250	250	-250	-200	-150	-100	-50	0	50	100	150	200	250
±400	400	-400	-320	-240	-160	-80	0	80	160	240	320	400
±500	500	-500	-400	-300	-200	-100	0	100	200	300	400	500

Таблица 5 Расчетное значение при определении погрешности для выхода 3

Выходной сигнал	Арасч, В										
	Сигнал отрицательной полярности, % от нижнего значения диапазона входного сигнала					Сигнал положительной полярности, % от верхнего значения диапазона входного сигнала					
	100	80	60	40	20	0	20	40	60	80	100
0 – 5 мА						0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
4 – 20 мА	-					0,40	0,72	1,04	1,36	1,68	2,00
0 – 20 мА						0	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00
4 – 12 – 20 мА	0,40	0,56	0,62	0,78	0,94	1,20	1,36	1,52	1,68	1,84	2,00
0 – 10 – 20 мА	0	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
±5 мА	-0,50	-0,40	-0,30	-0,20	-0,10	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
0 – 5 В						0	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
0 – 10 В	-					0	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00
0 – 2,5 – 5 В	0	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
0 – 5,0 – 10,0 В	0	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
±5 В	-5,00	-4,00	-3,00	-2,00	-1,00	0	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
±10 В	-10,00	-8,00	-6,00	-4,00	-2,00	0	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00

ИП считают годным, если для всех поверяемых точек основная погрешность не превышает ±0,5 %.

					УИМЯ.411600.048 МП					Лист
										5
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата		

4 Оформление результатов поверки

4.1 Результаты поверки оформляются протоколом по форме, приведенной в приложении Г.

4.2 Положительные результаты первичной поверки удостоверяются нанесением на корпус ИП в местах крепления крышки оттиска поверительного клейма, нанесением на лицевую поверхность ИП клейма-наклейки и записью в паспорте результатов поверки.

4.3 Положительные результаты периодической поверки удостоверяются нанесением на корпус ИП в местах крепления крышки оттиска поверительного клейма и нанесением на лицевую поверхность ИП клейма-наклейки.

4.4 При отрицательных результатах поверки ИП бракуется и выдается извещение о непригодности в соответствии с СТБ 8003-93 с указанием причин. При этом оттиск поверительного клейма и клеймо-наклейка гасятся.

					УИМЯ.411600.048 МП				Лист
									6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Перечень модификаций ИП и параметры входного сигнала и сигнала на выходе 3

Таблица А.1

Тип, модификация	Наличие		
	выхода 1 (порт RS-485)	выхода 2 (порт ПУ)	выхода 3 (аналоговый выход)
Е 857/1ЭС-Ц	Да	Да	Нет
Е 857/2ЭС-Ц	Да	Нет	
Е 857/3ЭС-Ц	Нет	Да	
Е 857/4ЭС-Ц	Да	Да	Да
Е 857/5ЭС-Ц	Да	Нет	
Е 857/6ЭС-Ц	Нет	Да	

Таблица А.2


Диапазоны преобразования входного сигнала, В	Диапазоны изменения сигнала на выходе 3	Номинальное значение сигнала на выходе 3	Сопротивление нагрузки на выходе 3, кОм
0-1; 0-5; 0-10; 0-60; 0-100; 0-150; 0-250; 0-400; 0-500	0 - 5 мА	5 мА	0-3,0
	4 - 20 мА	20 мА	0-0,5
	0 - 5 В	5 В	1,0 -100,0
	0 - 10 В	10 В	2,0 -100,0
±1; ±5; ±10; ±60; ±100; ±150; ±250; ±400; ±500	±5 мА	5 мА	0-3,0
	4 -12 - 20 мА	20 мА	0-0,5
	0 - 10 - 20 мА	20 мА	0-0,5
	0 - 2,5 - 5 В	5 В	1,0 -100,0
	0 - 5 - 10 В	10 В	2,0 -100,0
	±5 В	5 В	1,0 -100,0
±10 В	10 В	2,0 -100,0	

					УИМЯ.411600.048 МП	Лист
						7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Схема подключения приборов при определении основной погрешности ИП

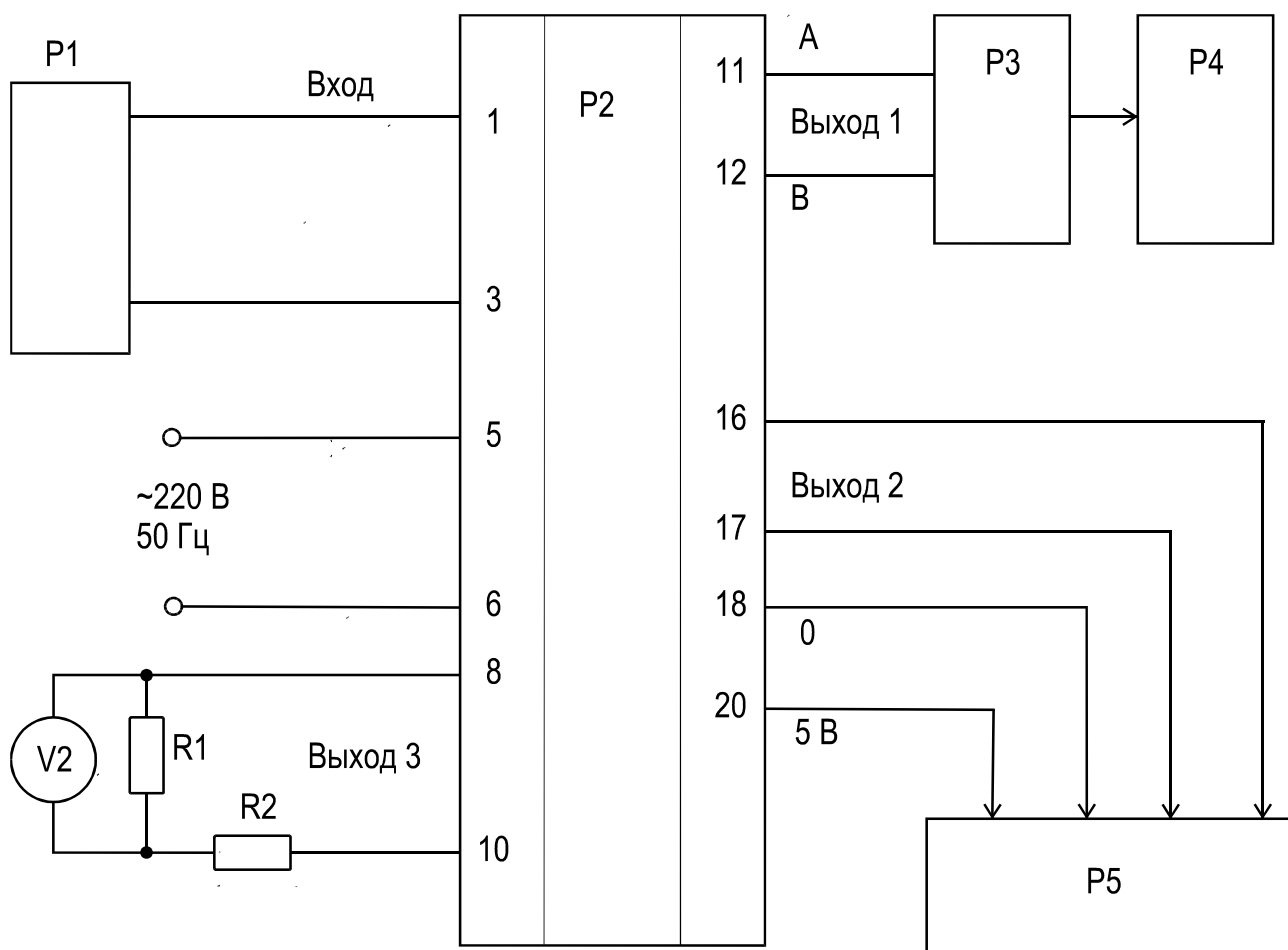


- P1 – калибратор программируемый П 320;
- P2 – ИП Е857ЭС-Ц;
- P3 – преобразователь уровней RS-232/RS-485;
- P4 – ПЭВМ;
- P5 – показывающее устройство ПУ-25;
- V1, V2 – вольтметр В7-65;
- R1 – катушка электрического сопротивления измерительная Р331, Rном=100 Ом;
- R2 – магазин сопротивления измерительный Р33

Примечание - Наличие или отсутствие выходов 1, 2, 3 – в соответствии с модификациями ИП, приведенными в приложении А

Рисунок Б.1 – Схема поверки ИП с выходным сигналом по току

					УИМЯ.411600.048 МП	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

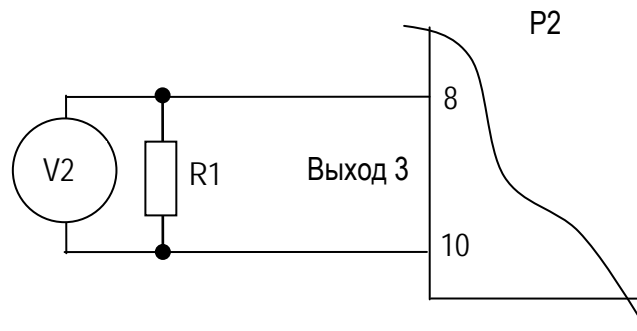


R1 - магазин сопротивления измерительный Р33, R= 2,5 кОм.
 Остальное - смотри рисунок Б.1.

Рисунок Б.2 - Схема поверки ИП с выходным сигналом по напряжению

					УИМЯ.411600.048 МП				Лист
									9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

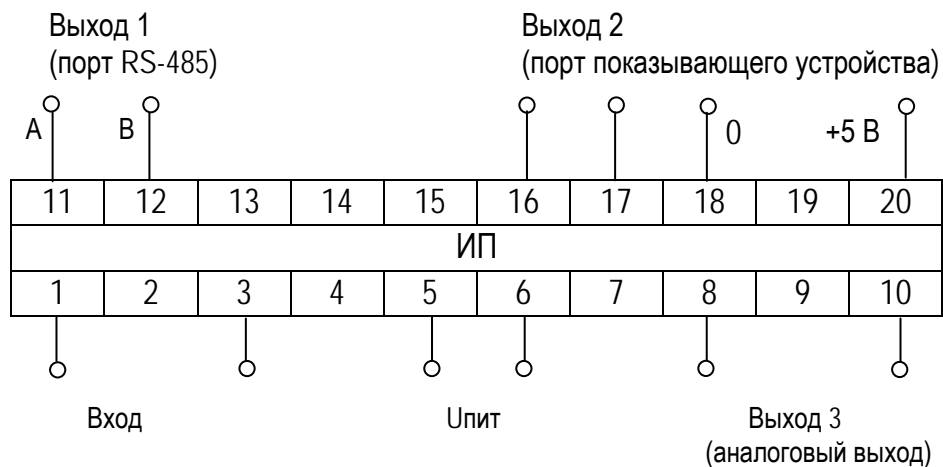

Наличие или отсутствие выходных цепей определяется модификацией ИП, указанной в приложении А.

Рисунок В.1 - Схема электрическая подключений ИП.

					УИМЯ.411600.048 МП				Лист
									10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

Протокол №

поверки преобразователя измерительного напряжения постоянного тока

Е 857/ ЭС-Ц № _____

Дата поверки _____

Изготовитель _____

Заказчик _____

Место поверки _____

Условия проведения поверки:

- температура окружающей среды, °C _____
- относительная влажность, % _____
- атмосферное давление, мм.рт.ст. _____
- напряжение питающей сети, В _____
- частота питающей сети, Гц _____
- вибрация, тряска, удары отсутствуют
- внешнее магнитное поле магнитное поле Земли

Средства поверки _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1 Внешний осмотр _____

(соответствует, не соответствует)

2 Определение электрического сопротивления изоляции

Проверяемые цепи _____ Измеренное значение _____

(соответствует, не соответствует)

3 Проверка электрической прочности изоляции

Проверяемые цепи _____ Испытательное напряжение _____

(соответствует, не соответствует)

4 Определение основной приведенной погрешности

Значение входного сигнала	Измеренное значение сигнала на выходах			Основная погрешность на выходах, %		
	1	2	3	1	2	3
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

(соответствует, не соответствует)

Заключение:

Преобразователь _____

годен, не годен. Указать причину

Поверитель _____ Подпись _____

					УИМЯ.411600.048 МП			Лист
								11
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Руководство по техническому обслуживанию программ

Установка программы УИМЯ.00001

В зависимости от установленной на используемом компьютере операционной системы, Windows-98 или Windows-XP необходимо руководствоваться соответствующим пунктом описания.

Установка программы УИМЯ.00001-01 для Windows-98

1. Установить дискету, поставляемую с методикой поверки, в дисковод 3.5 дюйма;
2. С помощью проводника открыть дискету («А:» или «В:» в зависимости от компьютера);
3. Открыть папку «98»;
4. Запустить программу «install»;
5. Открыть устройство «С:»;
6. Открыть папку «DemoE»;
7. Запустить программу «DemoE»;
8. Нажать на кнопку «Настройка» и произвести настройку Comn-порта (номера и скорости обмена), типа подключенного преобразователя RS-232/RS-485, интервала запросов, выбрать режим запуска опроса (смотри раздел «Описание органов управления»);
9. Нажать на кнопку «Ок». Программа запомнит все изменения;
10. Выйти из программы.

Установка программы УИМЯ.00001-02 для Windows-XP

11. Установить дискету, поставляемую с методикой поверки, в дисковод 3.5 дюйма;
12. С помощью проводника открыть дискету («А:» или «В:» в зависимости от компьютера);
13. Открыть папку «XP»;
14. Запустить программу «install»;
15. Открыть устройство «С:»;
16. Открыть папку «DemoExp»;
17. Запустить программу «DemoExp»;
18. Нажать на кнопку «Настройка» и произвести настройку Comn-порта (номера и скорости обмена), типа подключенного преобразователя RS-232/RS-485, интервала запросов, выбрать режим запуска опроса (смотри раздел «Описание органов управления»);
19. Нажать на кнопку «Ок». Программа запомнит все изменения;
20. Выйти из программы.

Поверка приборов

1. **ВНИМАНИЕ:** ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ОБЕСТОЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ!
2. Подключить к компьютеру преобразователь RS-232/RS-485;
3. Подключить к преобразователю RS-232/RS-485 поверяемый ИП;
4. Собрать схему поверки;
5. Включить компьютер, подать питание на преобразователь RS-232/RS-485 и поверяемый ИП;
6. Запустить программу УИМЯ.00001. Для этого при помощи проводника:
- открыть устройство «С:»;


					УИМЯ.411600.048 МП				Лист
									12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	

- открыть папку «DemoE» или «DemoExp» в зависимости от используемой операционной системы;
 - запустить программу «DemoE» или «DemoExp» в зависимости от используемой операционной системы.
7. Если не был выбран режим автоматического запуска опроса, нажать на кнопку «Опрос», иначе программа запустит опрос всех разрешенных приборов автоматически, примерно через 2 секунды после запуска программы;
8. Признаком начала опроса служит изменение наименования кнопки «Опрос» на «Прервать». Рядом с этой кнопкой появляется число, соответствующее выбранной скорости обмена.
9. Далее необходимо осуществить поиск подключенного ИП. Для этого:
- в области таблицы, запущенной программы, выбрать любую строку левой клавишей «мышки», после чего нажать правую клавишу «мышки»;
 - во всплывающем меню (смотри раздел «Описание органов управления»), в котором выбрать «Авто. поиск всех» или «Авто. поиск в диапазоне» в зависимости от того известно или нет какой сетевой номер у подключенного устройства;
 - в течение некоторого времени, зависящего от интервала запросов и количества заказанных для поиска приборов, программа будет искать подключенный ИП;
 - признаком запуска автоматического поиска будет наличие в колонке «?» символа «*» и последовательное уменьшение числа, левее кнопки «Очистить», с 4 до 0;
 - по окончании процесса автоматического поиска, правее кнопки «Пауза», будет отображено количество обнаруженных приборов, а также в колонке «?» будет стоять символ «*» только в той строке, номер которой соответствует найденному ИП, при этом программа запомнит этот номер для последующего быстрого опроса обнаруженного прибора.
10. Если заранее известен номер подключенного прибора, то можно из всплывающего меню разрешить его опрос. Для этого:
- выделить в таблице соответствующую строку левой клавишей «мышки»;
 - нажать правую клавишу «мышки» и во всплывающем меню выбрать пункт «Опрос разрешить».
- Аналогично можно поступить, если требуется исключить некоторый прибор из опроса.
11. После нахождения прибора поверить ИП в соответствии с пунктом 3.4 методики поверки. Измеренное значение Аизм. отображается в колонке «Выход».

					УИМЯ.411600.048 МП				Лист
									13
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	

Описание органов управления программы.

Режим «Настройка» на мониторе ПК выглядит следующим образом:

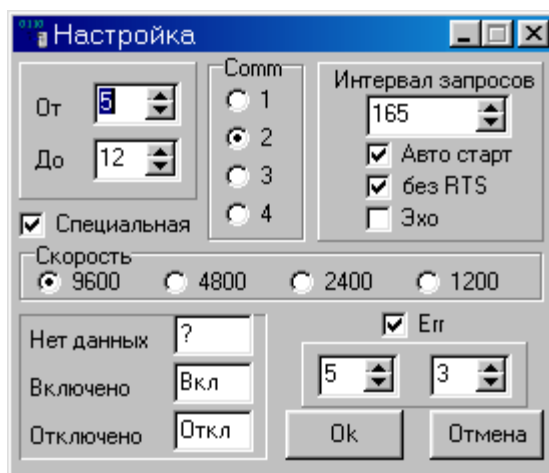

В данном примере:

«От», «До»

Комм

«Интервал запросов»

«Авто старт»

«без RTS»

«Эхо»

«Специальная»

«Скорость»

«Нет данных»

«Включено»

«Отключено»

«Err»

далее в данном примере

«5»

«3»

диапазон адресов для автоматического поиска;

номер Комм-порта;

период опроса каждого номера, от 165 мс до 1045 мс;

если установлен, осуществляется автозапуск опроса при старте программы (происходит примерно в течение 2 секунд после запуска программы);

если установлен, отсутствует принудительное переключение направления передачи данных в преобразователе RS-232/RS-485;

если установлен, программа ожидает «Эхо-сигнал» от преобразователя RS-232/RS-485;

изменение режима работы Комм-порта при использовании переносных компьютеров;

скорость обмена;

строка, отображаемая на основном экране, в тех строках, где не обнаружено приборов;

строка, отображающая состояние реле «Включено»;

строка, отображающая состояние реле «Отключено»;

включение/отключение контроля наличия обмена на линии RS-485;


количество запросов на устройство без ответа, подряд, для объявления его отсутствующим;

количество полных циклов опроса без ответа, для объявления неработоспособности аппаратуры.

При использовании переносного компьютера (notebook) следует включить режим «Специальная». При работе со стационарным компьютером режим «Специальная» не требуется.

					УИМЯ.411600.048 МП			Лист
								14
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата

В основном режиме работы вид экрана приведен ниже:

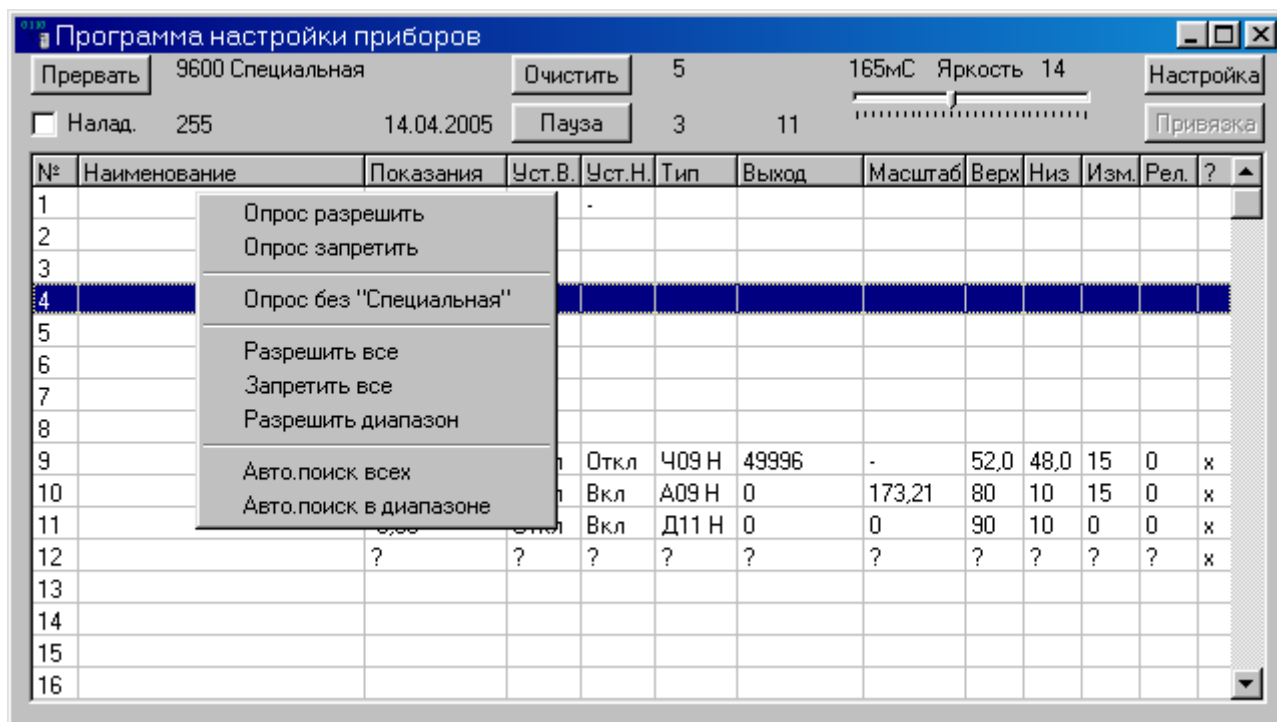

Назначение органов управления следующее:

- «Прервать» остановить/начать процесс опроса;
- «9600 Специальная» текущая скорость обмена и наличие соответствующего признака;
- «Очистить» удалить все данные из области отображения, сбросить все счетчики подтверждений и начать опрос с начала;
- «5» количество опрашиваемых устройств;
- «165 мС» период опроса;
- «Яркость 14» задание яркости свечения индикаторов, (не запоминается в подключенных устройствах);
- «Настройка» выход в окно настройки, было описано выше;
- «Налад.» открывает/закрывает окно отладки, показывающее в шестнадцатиричном виде принимаемые программой данные;
- «255» отображение процесса опроса, номер последнего запрошенного ИП;
- «14.04.2005» дата последнего изменения программы;
- «Пауза» приостановка/запуск процесса опроса;
- «3» количество обнаруженных устройств;
- «11» отображение процесса опроса, номер последнего обнаруженного ИП;
- «Привязка» изменение свойств выбранного прибора (наименование, сетевой номер, скорость обмена, значения уставок, масштаб отображения, время измерения, задержка на срабатывание реле). Данная функция доступна только в том случае, если выбранный прибор находится в режиме программирования (наличие символа «Н» в колонке «Тип»).

Всплывающее меню позволяет включить или отключить выбранный прибор в процесс опроса, осуществить автоматический поиск всех устройств, подключенных к компьютеру. Если прибор опрашивается, то в колонке, обозначенной как «?», присутствует какой-либо символ, в данном примере «х». Устройство с номером 255 опрашивается всегда.

					УИМЯ.411600.048 МП	Лист
						15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Назначение данных в таблице программы:

«№»	порядковый номер устройства, совпадает с сетевым номером;
«Наименование»	название устройства, задаваемое пользователем в процессе «привязки»;
«Показания»	показания прибора с учетом масштаба;
«Уст.В.»	состояние верхней уставки;
«Уст.Н.»	состояние нижней уставки;
«Тип»	тип прибора, обнаруженный по данному адресу: А активная мощность Р реактивная мощность Д действующее (ток и напряжение) Ч частота П постоянный ток и напряжение
Возможны комбинации приборов по типам измеряемых параметров. Дополнительные функции, обеспечиваемые прибором	
	'00' ничего
	'01' индикатор
	'02' аналоговый выход
	'03' аналоговый выход и индикатор
	'08' уставки
	'09' уставки и индикатор
	'10' уставки и аналоговый выход
	'11' уставки, аналоговый выход и индикатор
«Выход»	значение измеряемого параметра в единицах прибора;
«Масштаб»	число, которому соответствует номинальный входной сигнал, измеряемый прибором;
«Верх»	значение уставки на превышение, в %;
«Низ»	значение уставки на понижение, в %;
«Изм.»	время измерения прибора, в 0.1 сек;
«Рел.»	время задержки на срабатывание уставки, в 0.1 сек;
«?»	признак включения прибора в список опроса.

					УИМЯ.411600.048 МП			Лист
								16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата

Лист регистрации изменений

№ изменения	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

					УИМЯ.411600.048 МП				Лист
					УИМЯ.411600.048 МП				17
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	